CHAD drive inovo

呼吸同調式レギュレータ

スマートドーズ™

認証 227AFBZX00075000

スマートドーズは最適な酸素流量に
自動でアップ・自動でダウン

自動だから

面倒な切替の手間がかかりません

スマートドーズは通院や買物などで活動量が増えると呼吸数に応じた酸素量に自動でアップし供給します。帰宅後くつろいでいる時には自動でダウン。患者さまご自身で流量切替をする必要がないので、煩わしさを感じることがありません。

自動だから

酸素がムダに消費されることもありません

帰宅後の安静時に流量ダウンするのを忘れてしまい、ムダに酸素を消費してしまう…
スマートドーズなら、もうこんなことはなくなります。安静時には自動で流量ダウン。常に最適な量の酸素を供給するので、酸素のムダな消費がなくなります。

Patented
Breath Sensing

高感度	患者さまの呼吸に的確に反応し酸素を供給
軽量コンパクト	お出かけの妨げになりにくい440g（電池込）の軽量設計
電池長持ち1000時間	毎日３時間使用しても電池が約１年間持続
カンタン操作	スイッチを押すだけの手間なしカンタン操作

スマートドーズの流量自動調整機能

安静時流量2L/分に設定します（ボタン2）

活動時に呼吸数が増えると最大4L/分まで流量を**自動でアップ**

呼吸数が減ると、安静時流量2L/分に**自動でダウン**

流量の下げ忘れがないので、ムダに酸素を消費しません。

スマートドーズの酸素消費量は他社製品と変わりません。

※最大2ステップ　7L/分まで対応　　医師の処方が安静時 2L/ 分の場合

酸素流量の比較 (ml)	安静時 2L		活動時 4L
スマートドーズ	34±5	自動で流量アップ➡	67±5
A　社	23±5	手動で流量切替➡	43±5
B　社	28±5	手動で流量切替➡	54±5

※当社比（米国製同調器キャリブレーターによる測定）

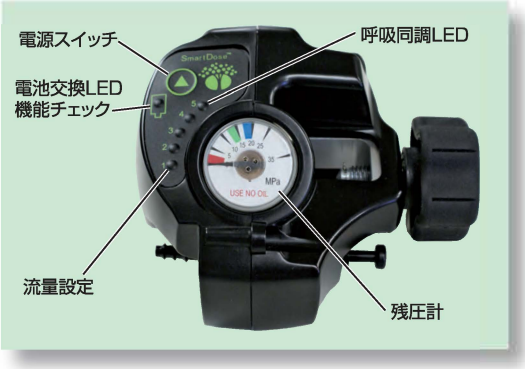

同調連続切替レバー

仕　様		
	名　　称	スマートドーズ®
	医療機器認証番号	227AFBZX00075000
	適用酸素容器	最高充てん圧力 19.6MPa
	使用温度範囲	−10～40℃
	使用湿度範囲	相対湿度 15～95%（結露なきこと）
	設定流量	1～2～3～4～5～（L/分）
	連続流量	2L/分
	呼吸同調回数	最大40回/分
	重　　量	440g（電池込）
	寸　　法	105mm(幅）×75mm(奥行）×125mm(高さ）
	電池寿命	約1000/時間（単3アルカリ乾電池2個）以上

◎製品の色は印刷物につき、実際のものとは異って見える場合があります。◎本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合があります。
◎ご使用の前に取扱い説明書を必ずお読みください。

SmartDose®

ご用命は

RUFUTO

製造販売業者
日本ルフト株式会社
〒101-0054　東京都千代田区神田錦町2-7-5 協販ビル
TEL: 03-3518-2001　FAX: 03-3518-6001

1906.5000E